

# ANMAT advierte sobre unidades falsificadas de Implantes RB SRL- Tornillo de interferencia p/LCA. TI

Se trata de un producto médico de riesgo III indicado para la fijación de fracturas.

Publicado el martes 14 de mayo de 2024

---

ANMAT informa que durante la fiscalización de rutina en un establecimiento distribuidor de productos médicos, se han detectado unidades falsificadas de un tornillo de interferencia identificado como **Implantes RB SRL- Tornillo de interferencia p/LCA. TI**.

El producto médico se encuentra registrado en la República Argentina por la firma **Implantes RB**, mediante **PM N° 1378-01**, bajo la clase de riesgo III y están indicados para la fijación de fracturas.

**El producto original es un tornillo de color azul metalizado** que posee grabado en la cabeza del tornillo el lote y la medida, estos datos coinciden con la información consignada en la etiqueta que posee el pouch en el que se encuentra acondicionado. Mientras que **el tornillo falsificado es de color gris opaco**.

Por lo expuesto, se solicita al personal de salud, distribuidores, instituciones y a la población en general verificar las unidades en existencia y **en caso de contar con aquellas con las características descritas** contactarse con esta Administración Nacional a través del correo electrónico [pesquisa@anmat.gob.ar](mailto:pesquisa@anmat.gob.ar) o comunicarse con [ANMAT Responde](#).

Se adjuntan a continuación imágenes comparativas entre la unidad original y la falsificada:

**Falso:**



**Implantes**  
**RB**  
S.R.L.

Lopez y Planes 2318  
Tel: (0351) 4585196 - Córdoba

**TORNILLO**  
**TORNILLO DE INTERFERENCIA P/LCA TI**

Medida: Ø 8 X 30 MM - ROMO  
1º Lote/Serie: 10749  
Condición: ESTERIL  
Fecha de fabricación: 09/2018  
Fecha de Esterilización: 06/10/2021  
Método: Esterilización por ETO  
Producto médico autorizado por ANMAT PM 1378-01  
Dir. Téc. Farm. María Elena CHIODI MP 3086


ENVA SE POR 1 UNIDAD

Vencimiento: 06/10/2025  
Lugar de esterilización: Elwyn

**RA**  
10/21

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS  
NO UTILIZAR SI EL ENVA SE NO ESTA INTEGRO

Original:

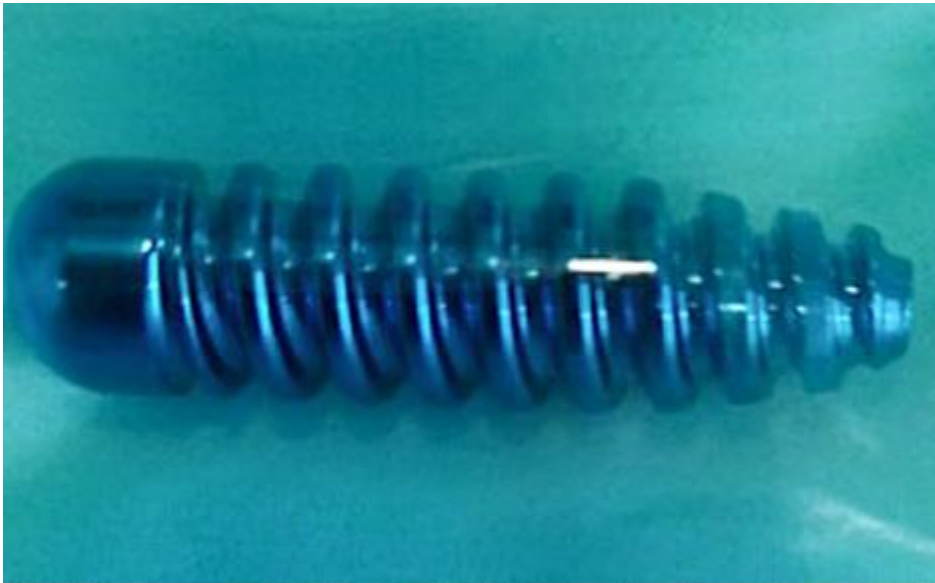

**Implantes**  
**RB**  
S.R.L

Lopez y Planes 2318  
Tel: (0351) 4565196 - Córdoba

**TORNILLO**

**TORNILLO DE INTERFERENCIA P/LCA TI**

Medida:  $\varnothing 8 \times 30$  mm - ROMO

Nº Lot/Serie: 15748-110 · ENVASADO POR 1 UNIDAD

Condición: ESTERIL

Fecha de Fabricación: 11/2022

Fecha de Esterilización: 08/11/2022      Vencimiento: 08/11/2026

Método: Esterilización por ETO      Lugar de esterilización: Elwyn

Producto médico autorizado por ANMAT      PM 1378-01

Dir. Téc. Farm. Mariana CHIODI      MP 3086

**MATERIAL DE UN SOLO USO**  
**VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**  
**NO UTILIZAR SI EL ENVASE NO ESTÁ ÍNTEGRO**

# ALERTA



## ANMAT advierte sobre unidades falsificadas de Implantes RB SRL- Tornillo de interferencia p/LCA. TI

Se trata de un producto médico de riesgo el cual debe pasar la fijación de fracturas.

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[LinkedIn](#)
[WhatsApp](#)
[Telegram](#)

Publicado el martes 15 de mayo de 2018

Se detectó una mala que durante la fijación de fracturas en un establecimiento, detectó un lote de productos médicos, de tipo ortodóncico, unidades falsificadas de un tornillo de interferencia identificado como **Implantes RB SRL- Tornillo de interferencia p/LCA. TI**.

El producto médico se encuentra registrado en la República Argentina por la forma **Implantes RB - Tornillo RB-PM-01- 1278-01**, bajo la clase de riesgo II y está indicado para la fijación de fracturas.

El producto original es un tornillo de color azul metalizado que posee grabado en la cabeza del tornillo el logo y la medida, estas características con la información, corresponden al lote que posee el parámetro de que se encuentran autorizados. Mientras que el **tornillo falsificado es de color gris opaco**.

Por lo expuesto, se solicita al personal de ventas, distribuidores, instituciones y otros, publicación en general, verificar las unidades en existencia y en caso de contar con aquellas con las características descriptas, contactar con esta administración. Para más detalles del curso electrónico [pueden ingresar al siguiente enlace con ANMAT](#) [Falsificación](#).

Se sugiere a continuación, el lugar de comparación entre la unidad original y la falsificada.

Falso:



Original:

